


PROCESO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS LABORATORIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

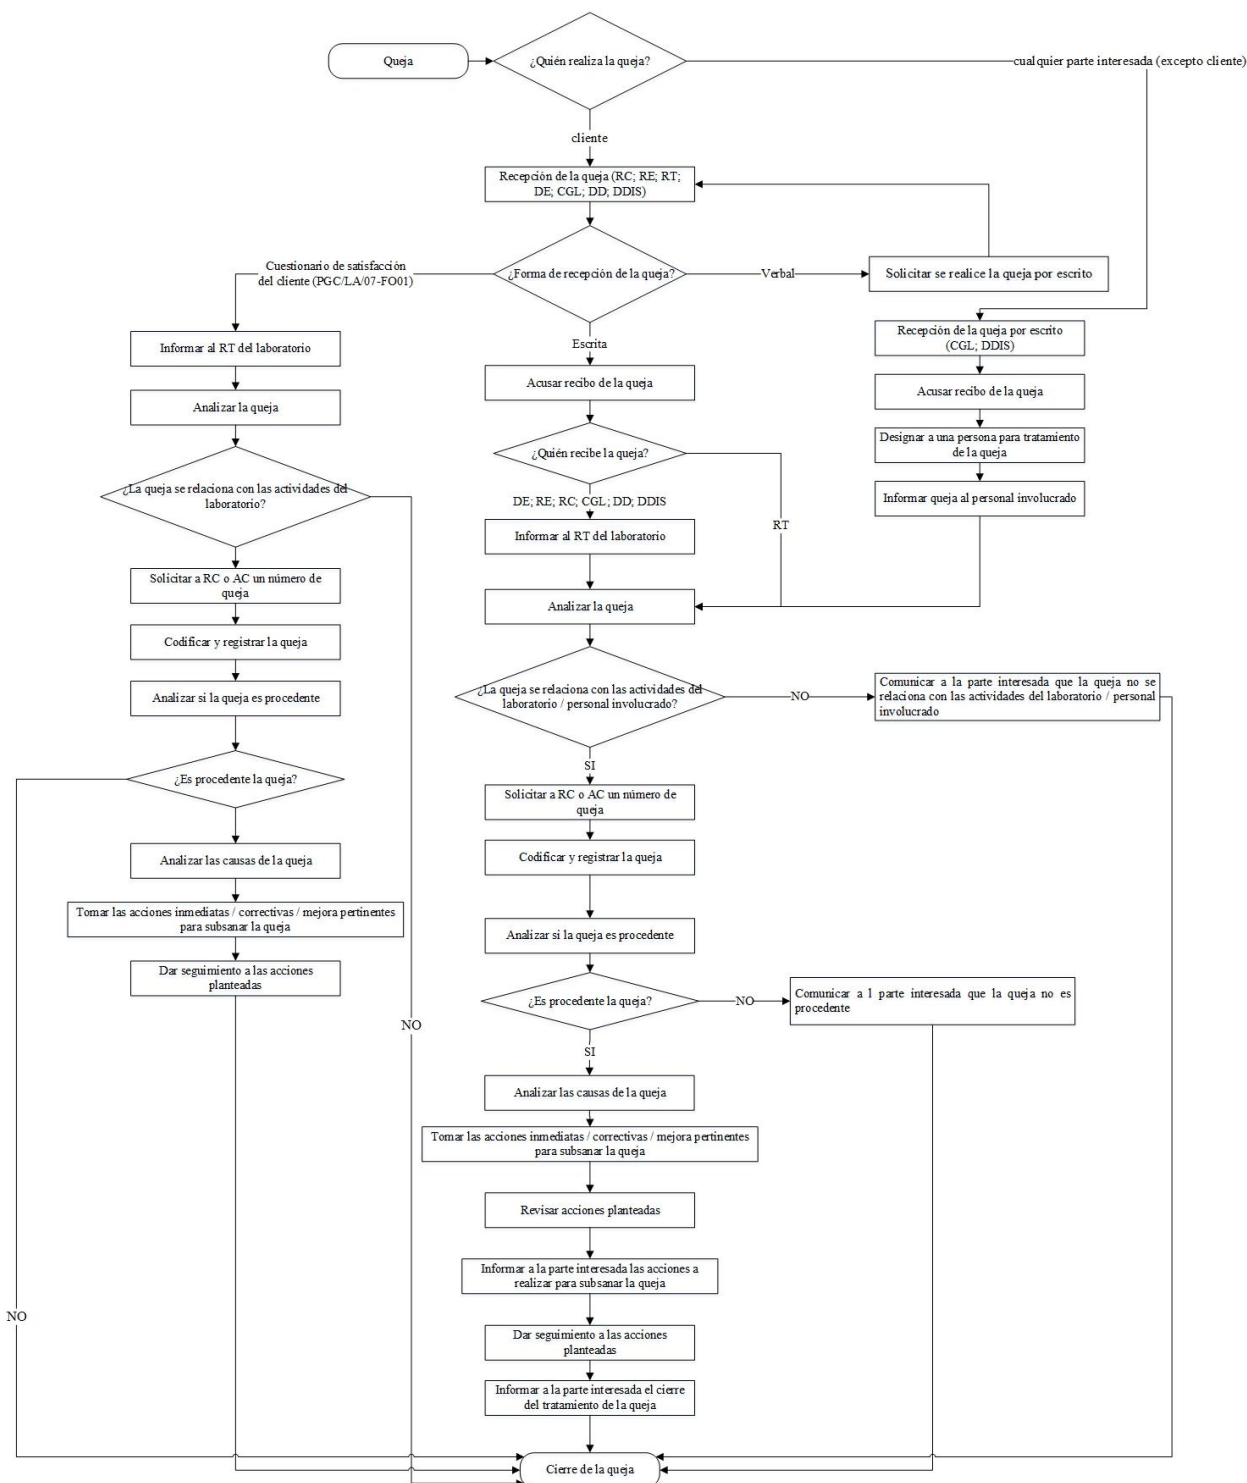

Abreviaturas:

RC: Responsable de calidad
RE: Recaudador
RT: Responsable Técnico
DE: Director Ejecutivo
CGL: Coordinador General de Laboratorio
DD: Director de Diagnóstico
DDIS: Director Distrital

Sus quejas pueden ser receptadas a los siguientes contactos:

RECAUDADORA: Paulina Prado (paulina.prado@agrocalidad.gob.ec)

RESPONSABLE DE CALIDAD: Carolina Campos (carolina.campos@agrocalidad.gob.ec)

COORDINADORA GENERAL DE LABORATORIOS: Carla Moreno (carla.moreno@agrocalidad.gob.ec)